

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒๘ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๕๑๐ บาท
- ๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๙๙,๕๑๐ บาท
- ๔ แหล่งที่มาราคากลาง
- ๔.๑ เป็นราคามาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ปี ๒๕๕๘
- ๔.๒
- ๔.๓
- ๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๑ นางกานต์นิษา แดงน้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คานหาม สสอ.อุทัย
- ๕.๒ นายสุวิษ ถมมะสังข์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.คานหาม สสอ.อุทัย
- ๕.๓ นางสาวน้ำฝน สีตะระโส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.คานหาม สสอ.อุทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โทร ๐๓๕-๘๐๐๕๓๘)

ที่ อย ๑๔๓๒.๑๐๑/ ๗๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. เรื่องเดิม


ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๕๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของวัสดุการแพทย์ โดยใช้หลักเกณฑ์คุณลักษณะและราคารามาตรฐานตามที่สำนักงบประมาณกำหนดของ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง วัสดุการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) และขอใช้ราคาที่ได้ดังกล่าวเป็นราคาสำหรับการจัดซื้อต่อไป

๓. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางกานต์นิชา แดงน้อย)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เห็นสมควรใช้ราคาที่คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ในวงเงิน ๑๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
เป็นราคาสำหรับการจัดซื้อ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุวิษ ถมมะสังข์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวน้ำฝน สีตะระโส)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


(นางเอเลียว จำแนกวุฒิ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายบุญชอบ สระสมทรัพย์)
สาธารณสุขอำเภออุทัย

-  Onmit
-  Thani Nuan
สาธารณสุขอำเภออุทัย

(นายศิรัชย์ อัมพวา)
นายอำเภออุทัย

คุณลักษณะและราคากลางวัสดุการแพทย์
 จำนวน ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

อันดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา	เครื่อง	๗	๓,๘๐๐	๒๖,๖๐๐
๒	เครื่องวัดความดันปรอท	เครื่อง	๒	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐
๓	กรรไกรตัดเนื้อ ๑๔.๕ cm.	อัน	๓๐	๔๕๐	๔,๕๐๐
๔	กรรไกรตัดไหม ๑๔.๕ cm.	อัน	๓๐	๓๕๐	๓,๕๐๐
๕	Non-tooth forep ๔-๕ นิ้ว	อัน	๓๐	๒๙๐	๒,๙๐๐
๖	tooth forcep ๔-๕ นิ้ว	อัน	๓๐	๒๙๐	๒,๙๐๐
๗	เข็มเจาะเบาหวาน ๒๐๐ชิ้น/กล่อง	กล่อง	๓๐	๙๕๐	๙,๕๐๐
๘	แถบตรวจน้ำตาล Aecn-CHEK -๒๕ Test	กล่อง	๕	๕๕๐	๒,๗๕๐
๙	หุฟิงแพทย์ผู้ใหญ่	เส้น	๕	๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	Ambu bag ผู้ใหญ่	ชุด	๑	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐
๑๑	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	เครื่อง	๑	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐
๑๒	ภาดหลุมทำแผล	ใบ	๓๐	๔๕๐	๔,๕๐๐
๑๓	กล่องเครื่องมือแพทย์ ๑๒x๘x๒.๕	ใบ	๓	๗๕๐	๒,๒๕๐
๑๔	กล่องสำลี ๔x๒.๕	ใบ	๔	๓๐๐	๑,๒๐๐
๑๕	รถฉีดยา ๔๐x๕๐x๘๐ ๑ ลิ่นชัก	คัน	๑	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐
๑๖	ตะแกรงทำแผล	ตัว	๑	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐
๑๗	ถังขยะสแตนเลสกลมใช้เท้าเหยียบมีล้อ ๑๖ ลิตร	ใบ	๖	๓,๕๐๐	๒๑,๐๐๐
๑๘	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	คัน	๑	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐
๑๙	เกจ์ออกซิเจน พร้อมชุดปริมาตร ๔,๕๐๐ psi	ชุด	๑	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐
๒๐	กระเป๋แพทย์เคลื่อนที่เล็ก	ใบ	๑	๗๕๐	๗๕๐
๒๑	Taylor percussion Hammwer ค้อนยางเคาะเข้า	อัน	๑	๔๘๐	๔๘๐
๒๒	Larycoscope เครื่องตรวจคอ	ชุด	๑	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐
๒๓	ขวดแก้วสีขา ๑๒๕ cc	ใบ	๖	๙๕	๕๗๐
๒๔	ขวดแก้วสีขา ๑๒๕ cc	ใบ	๖	๘๕	๕๑๐
๒๕	เหล็กกดลิ้น ๑๕ cm	อัน	๒๐	๖๕	๑,๓๐๐
๒๖	หม้อน้ำความดันสแตนเลส ๑๒ ลิตร+พร้อมเตาแก๊สตั้ง	ชุด	๑	๑๓,๙๐๐	๑๓,๙๐๐
๒๗	เตียงตรวจนารีเวช	ตัว	๑	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐
๒๘	โคมไฟส่องตรวจภายใน	ตัว	๑	๑๐,๙๐๐	๑๐,๙๐๐
จำนวนเงินรวม หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน				รวม	๑๙๙,๕๑๐

(ลงชื่อ)

(นางกานต์ณิชา แดงน้อย)

(ลงชื่อ)

(นางสาวน้ำฝน สีตระระโส)

(ลงชื่อ)








(นายสุวิษ ธรรมะสังข์)

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพารัดแขน omrom

เลข 196/2557



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
จอรวม รุ่น HEM-7130
รุ่นนี้มี Guest mode

-  ไฟสัญญาณแสดงเมื่อมีการเพิ่มพลาสมาอย่างถูกต้อง
-  แกนบอกระดับความดันโลหิต
-  แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ
-  แสดงการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดันโลหิต
-  หน่วยความจำบันทึกได้ 60 ครั้ง (พร้อมวันที่และเวลา)
-  ใช้ถ่าน AA x 4 (อายุการใช้งาน 1,000 ครั้ง)
-  ค่าเฉลี่ย 3 ครั้งสุดท้ายที่วัดภายใน 10 นาที

ดูภาพสินค้าและรายละเอียดได้ที่ www.omron-healthcare.co.th
เลขที่ 196 ก.สารคดี แขวงถนนพญาไชย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10120 โทร 02-670-8099
ศูนย์บริการลูกค้า: 1677-8888

All for Healthcare

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ มีหน้าจอ SPIRIT รุ่น CK101

ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน




(นางกานต์ศิลา แสงจันทร์)


(นางศุภิรา อมระสิทธิ์)


(ดร. นันทิมา สันทรวิโร)

กรรไกรผ่าตัด (Operating Scissor)




กรรไกรตัดไหม (iris scissors)



Tissue Forcep ปากคืบ ฟอซเซิน แบบไม่มีเขี้ยว




(นางอภานันท์สินี งามรัตน์)


(นายสุภัทร อมระสิทธิ์)


(ดร. สันติพงษ์ สันติสุข)

Dressing Forcep ปากคืบ ฟลอร์เซิน แบบมีเขี้ยว



Accu-chek safe-T-pro uno lancets กล่องละ 200 ชิ้น



แถบตรวจน้ำตาลในเลือด Accu-Chek Performa Test Strip มีขนาดบรรจุ 25 ชิ้น



mi

(นางกานต์กริชชา แดงรัตน์)

[Signature]

(นายสุวิธ อมวตสิทธิ์)

พินิจ สันตกิจ

(นส. นันทิภา สันตกิจ)

หูฟังแพทย์ STETHOSCOPE 3M รุ่น LITTMANN CLASSIC II

รายละเอียดทั้งหมด :

- Model Littmann Classic II S.E.
- มีความไว (Sensitivity) ต่อการรับฟังเสียง และสัมผัสได้แบบเนียน
- หูฟังสามารถปรับฟังได้ 2 ด้าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ปุ่มเสียบหู (Eartips) เป็นชนิดแบบนุ่มกระชับ
- ผลิตภัณฑ์ 3M ประเทศ อเมริกา



ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ Ambu bag

ครบชุดสำหรับผู้ใหญ่ มีหัว galemed รุ่น MR-100 PLUS ประเทศไต้หวัน



กช
(นางสาวกชกัญญา แดงพันธ์)

ศิริ
(นางศุภิรา อามระศิริ)

พญ. อังกรณี
(น.ศ. อังกรณี ศัตตวโรส)

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Fingertip มีชื่อ BEURER รุ่น PO30



รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่น PO30

Pulse Oximeter model PO30

คุณสมบัติ

- วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2)
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (ความถี่ชีพจร)
- ขนาดเล็กและเบา - เหมาะกับใช้ที่บ้านและพกพา

คุณลักษณะ

- ง่ายต่อการอ่าน-หน้าจอสี
- ปรับความสว่างหน้าจอได้
- การแสดงผล-กราฟิกของชีพจร
- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
- แกรม พร้อมกระเป่าและเข็มขัดรัด
- แกรม ไขถ่าน AAA x 2
- ขนาด 61 x 36 x 32 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ 57g
- รับประกัน 3 ปี
- ผลิตภัณท์ BEURER , GERMANY

น.ส. น.ส.
(นางพนทิศา แววค์น.)

น.ส. น.ส.
(นางศุภิรา อภิมะสิริวิง)

น.ส. น.ส.
(น.ส. น.ส. น.ส. น.ส.)

ถาดหลุมห้าแผล



กล่องเครื่องมือแพทย์ พร้อมฝา



กล่องใส่สำลี 4*25



น้ำ
(ภาชนะคัดลอก แคมป์)

น้ำ
(ภาชนะคัดลอก กรมอสังหาริมทรัพย์)

น้ำ
(ภาชนะคัดลอก สังกะสี)

เครื่องตรวจหู ตรวจตา มีชื่อ Kawe รุ่น Piccolight F.O./E50

รายละเอียดสินค้า

ชุดตรวจหู

1. ชุดกรวยเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2.5mm และ 4.0mm
2. กระจ่างผ่าเก็บอุปกรณ์อย่างดี
3. ไขถ่านอัลคาไลน์ AA 1.5V จำนวน 2 ก้อน

ชุดตรวจตา

1. หัวตรวจตา มีทั้งหมด 6 Diaphragm
2. สามารถปรับคมชัดของภาพ โดยเลือกปรับเลนส์ได้ตั้งแต่ +/- 20dp

ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน



มี
(นางพนทศกิตติภา แดงพันธ์)

มี
(นางกัญญา ตมมาสิงห์)

มี
(น.ส. นันทิยา สัตยารัตน)

รถฉีดยา

Size 40x50x80 cm.

1 ล้อขับเคลื่อน และ 1 ชั้น โครงทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ซม.

ทำด้วยสแตนเลส ใส่ลูกล้อขนาด 3" มีขอบทงาย 3 ด้าน ข. มีที่รัดขวดยา

****รับประกันตัวโครง 1 ปี ส่วนล้อรับประกัน 1 เดือน*****ภาพสินค้าทุกชิ้นถ่ายจากสินค้าจริง*****



ตะแกรงล้างแผล

รายละเอียดสินค้า

ที่ล้างแผล Dressing Stool Size 38x54 cm.

ปรับสูงต่ำได้ 75-100 ซม. ทำด้วยสแตนเลส ใส่ลูกล้อ ขนาด 2"

****ตัวโครงรับประกัน 1 ปี ส่วนล้อรับประกัน 1 เดือน*****ภาพสินค้าทุกชิ้นถ่ายจากสินค้าจริง*****



มี
(นางสาวกมลทิพย์ แควนชัย)


(นายสุวิทย์ อมระวิจิตร)

มี
(นส.กัญญา สัมพันธ์)

ถังขยะเท้าเหยียบ Trash Bucket

รายละเอียดสินค้า

Size 28x38 cm.

ทำด้วยสแตนเลส ใส่อุ้งขนาด 2"



รถเข็นผู้ป่วยแบบมาตรฐาน รุ่น FS809

ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม รับน้ำหนักผู้ป่วย ได้ถึง 100 kg.



ม/ว
(นางวราภรณ์ กิ่งฟ้า แดงน้อย)


(นางหิรัญญา สมองศิริ)

นาง อังคนิศา
(นศ. น้าฝน สัตหาลือ)

เกจ์ออกซิเจนพร้อมชุด ปริมาตร 4,500psi



รายละเอียดสินค้า

ในชุดประกอบด้วย


- + ออกซิเจน โฟมิเตอร์
- + Regulator ปรับแรงดัน
- + กระจเปาะ Humidier
- + สายแคนบูล่า
- + Adapter สำหรับต่อเข้าชุดเจาะคอ


(นายแพทย์กฤษฏา แดงนงนพ)


(นายแพทย์ก.จอมวงศ์วิทย์)

เชิดน ชิตนทร์
(ร.ร. สักกะ สิมะโรติก)

Cold Light Lamp With Single Reflector Floor Type

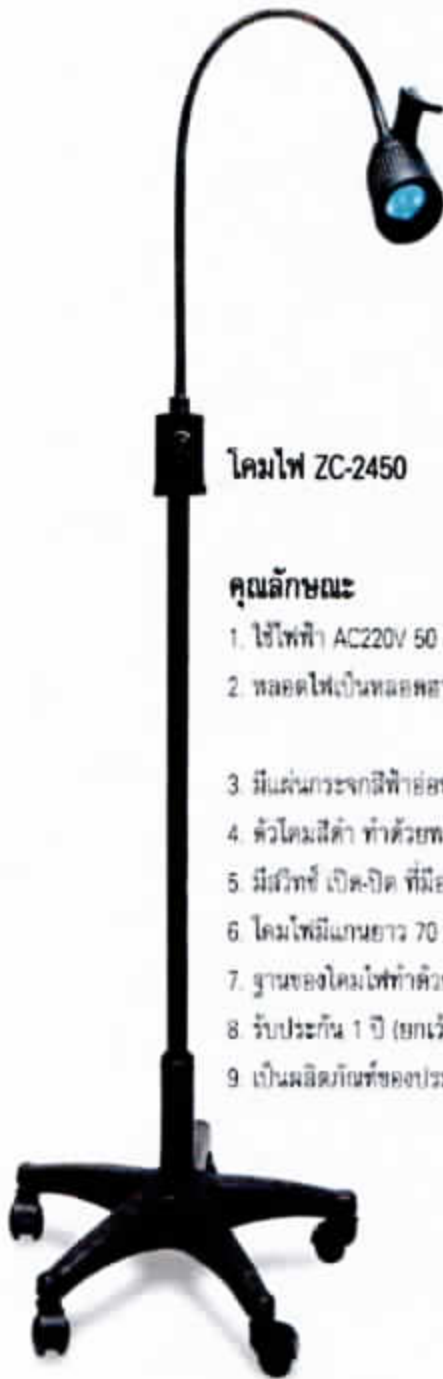

โคมไฟ ZC-2450



คุณลักษณะ

1. ใช้ไฟฟ้า AC220V 50 Hz ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น DC 12 V จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
2. หลอดไฟเป็นหลอดฮาโลเจน กระบอกกันรังสีความร้อน (UV) ใช้ไฟ 12V 35-50 W
3. มีแผ่นกระจกสีฟ้าอ่อน กรองรังสีความร้อน
4. ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกทนทานอย่างดี ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
5. มีสวิทช์ เปิด-ปิด ที่มีจับตัวโคม และมีชุดปรับแสงสว่างที่ตัวโคม
6. โคมไฟมีแกนยาว 70 ซม. สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
7. ฐานของโคมไฟทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีมือ 5 มือ, เคลื่อนย้ายสะดวก
8. รับประกัน 1 ปี (ยกเว้นหลอดไฟ)
9. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

Technical Data

ชื่อรุ่น ของสินค้า	สี	ขนาด ของหลอดไฟ	ขนาดของหลอด ฮาโลเจน	ระดับความสูง	ขนาดของ แกนโคมไฟ	V (W) ใช้ไฟฟ้า	(VA) ที่ไฟ	(W) หลอดไฟ
ZC-2450	ดำ	3,000 - 4,200	80 - 150	700	70	220/50	50	35-52

SHANTOU WELFARE MEDICAL APPARATUS FACTORY GUANGONG P.R. CHINA

(นางกมลทิพย์ มงคลรัตน์)

(นายคณิศร มงคลรัตน์)

เป็น 8000/E
(นส. ชัยชนะ หักกะโรย)

เตียงตรวจนรีเวช PV (Gynecological Medical Bed)

เตียงตรวจภายใน

- ขนาด 57 x 185 x 80 ซม.
- เตียงทำด้วยสแตนเลส 3 ตอนปรับระดับได้ พร้อมขาหยั่ง 1 คู่
- พื้นรองนั่งนุ่มผ้าหนังเทียม



หม้อนิ่งความดัน Autoclave Sterilizer สแตนเลสใช้แก๊สแบบมือหมุน ยี่ห้อ Atlas

รุ่น AUS 206 ขนาดบรรจุ 12 ลิตร



^ม
(นางกานต์ฉิภา เกษมรัตน์)


(นางศุภิษา อมระสิงห์)

เชิดน อัคราภิรักษ์
(นศ. ชินฉวี ศักดิ์ศรีโส)